


Anleitung Schritt für Schritt

GLY 742 (GLY wäss. / GLY org.)

Einzelmessung

Hinweis: Vor der Messung Probenvorbereitung gemäß Packungsbeilage durchführen

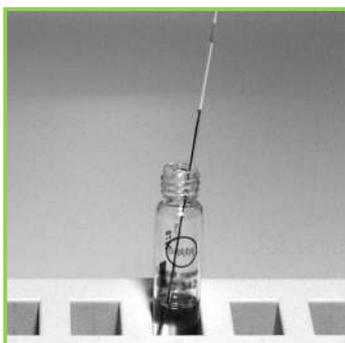


1. Kapillare mit 10 µL Probe in die geöffnete Küvette stellen



2. Probe mit Mikropipetter ausstoßen und mehrfach spülen




3. Verschlusskappe wieder aufschrauben
Küvette mehrmals über Kopf schwenken

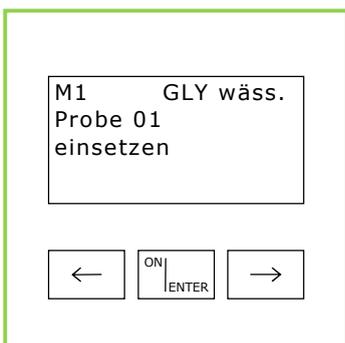

4. Gerät mit ON/ENTER einschalten

Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen

Gewünschten Test auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

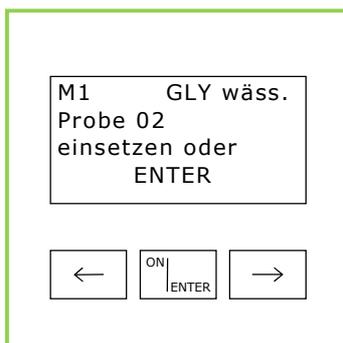

5. Nullpunkteinstellung: Küvette mit Probe (Bild 3) in das Photometer stellen, Nullpunkt wird vom Gerät gespeichert


Nach Signalton Küvette entfernen



6. Verschlusskappe gegen Startkappe austauschen



7. Küvette mehrmals über Kopf schwenken

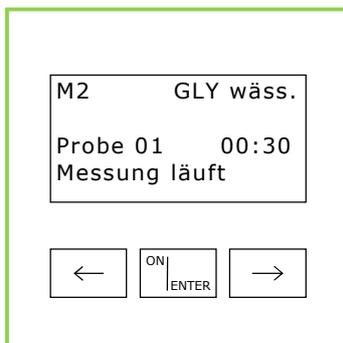

8. Zuerst ON/ENTER drücken und erst **danach** die Küvette in das Photometer stellen




9. Zeitablauf wird angezeigt, Messwert abwarten

Anleitung Schritt für Schritt

GLY 742 (GLY wäss. / GLY org.)

Serienmessung / Anzahl der Proben pro Serie: Bis zu 20 Proben parallel


Hinweis: Vor der Messung Probenvorbereitung gemäß Packungsbeilage durchführen

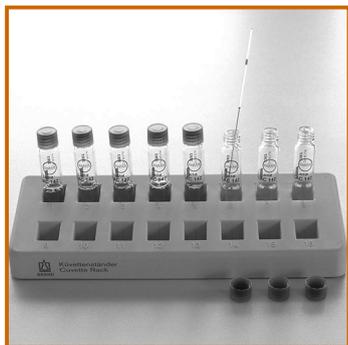


1. Die Proben in den Kapillaren nacheinander mit dem Mikropipetter in die Küvetten ausstoßen und mehrfach spülen



2. Verschlusskappen wieder aufschrauben
Küvetten mehrmals über Kopf schwenken

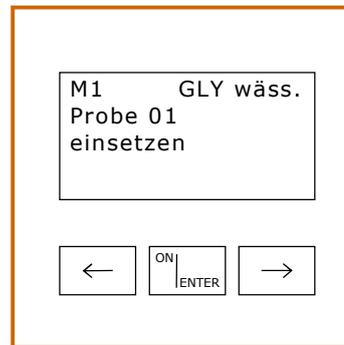

3. Gerät mit ON/ENTER einschalten
Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen
Gewünschten Test auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

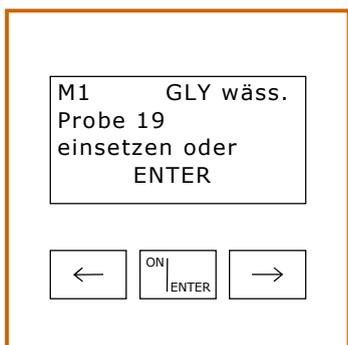


4. Nullpunkteinstellung: Küvetten mit Probe (Bild 2) nacheinander in das Photometer stellen
Die Nullpunkte werden vom Gerät gespeichert
Auf korrekte Reihenfolge der Proben achten!



5. Nach Nullpunkteinstellung der letzten Küvette alle Verschlusskappen der Reihe nach gegen Startkappen austauschen




6. Alle Küvetten **gleichzeitig** mehrmals über Kopf schwenken

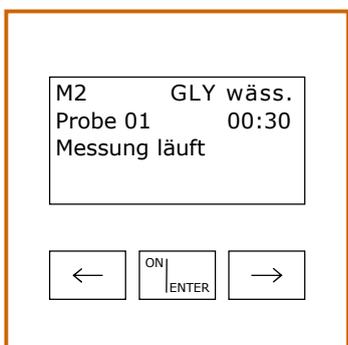

7. Zuerst ON/ENTER drücken und erst **danach** die **1.** Küvette in das Photometer stellen
Zeitablauf wird angezeigt, Messwert abwarten



8. Messwert der 1. Küvette ablesen, Küvette entfernen
2. Küvette einsetzen, Messwert ablesen, Küvette entfernen, usw.

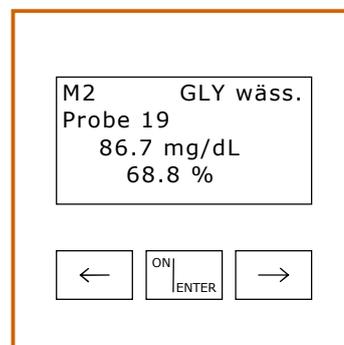

9. Vorgang solange wiederholen, bis der Messwert der letzten Küvette angezeigt wird
Auf korrekte Zuordnung und Reihenfolge der Proben achten!